

# 臨床検査に関するお知らせ



株式会社セントラル医学検査研究所  
TEL(本社)029-225-8858 (下館)0296-28-5900

先生各位

平成 29 年 3 月  
A-17-09

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  
また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
この度、下記検査項目におきまして、改良試薬への変更に伴い検査内容を変更させて頂きたくご案内致します。  
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

◆ 実施日 平成 29 年 3 月 31 日 (金) ご依頼分より

◆ 変更内容


2016・17年 検査案内	項目 コード	検査項目	変更箇所	新	旧
p.23	13030	HIV-1 定量 (リアルタイム PCR)	検体量	血漿 2.0mL	血漿 3.5mL
p.29	14440	HBV-DNA 定量	報告範囲	検出せず, <1.0+, 1.0~9.1 以上	検出せず, <1.3+, 1.3~8.2 以上
	14310	HCV-RNA 定量	報告範囲	検出せず, <1.2+, 1.2~8.1 以上	検出せず, <1.2+, 1.2~8.0 以上

※ 尚、検査方法、基準値等の変更はございません。新旧の比較は裏面をご参照下さい。

◆ 新旧の比較


HIV-1 定量

(Logcopy/mL)

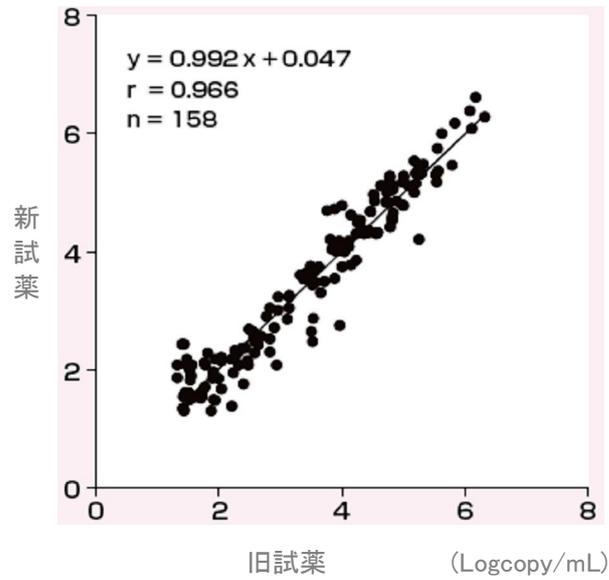

HBV-DNA 定量

(L.IU/mL)

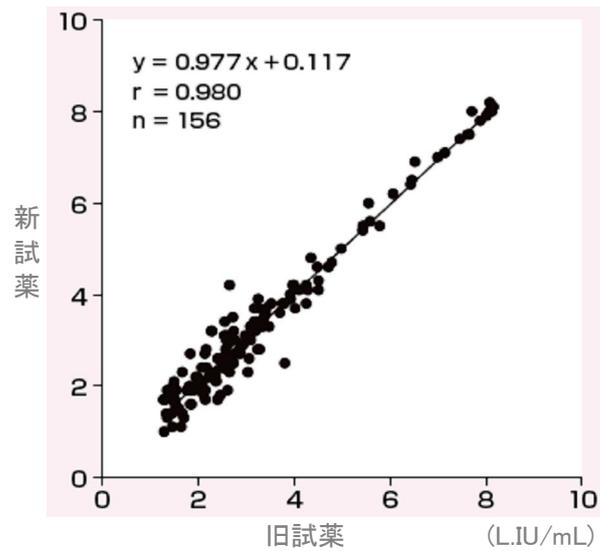

HCV-RNA 定量

(L.IU/mL)

