

臨床検査に関するお知らせ



株式会社セントラル医学検査研究所

TEL(本社)029-225-8858 (下館)0296-28-5900

先生各位

平成 27 年 1 月

A-15-04

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記検査項目につきまして、試薬販売会社より測定試薬の製造販売を中止するとの連絡が急遽ございました。これに伴い、検査内容を変更させて頂きたくご案内申し上げます。

急な変更で先生方には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 実施日 平成 27 年 1 月 29 日 (木) ご依頼分より

◆ 変更内容

2014・15年 検査案内	項目 コード	検査項目	変更箇所	新	旧
p.31	18790	アンドロステンジオン	検体必要量	血清 0.5mL	血清 0.4mL
			材料保存法	冷凍 (遠心分離後、上清液を凍結)	冷蔵
			検査方法	RIA 硫安塩析法	RIA 固相法
			基準値	(裏面参照)	(裏面参照)
			報告範囲	0.10 未満、 0.10~99999999	0.1 以下、 0.1~99000000
			所要日数	8~15 日	3~10 日

尚、基準値と新旧相関図は裏面をご参照下さい。


●●● アンドロステンジオン ●●●

◆ 基準値

(単位：ng/mL)

年齢 (歳)	新		旧	
	男性	女性	男性	女性
20～29	0.48～1.82	0.64～2.34	1.2～2.5	1.1～3.9
30～39	0.42～1.52	0.57～2.24	1.0～3.2	0.9～3.5
40～49	0.46～1.67	0.28～1.35	1.0～2.9	0.6～2.2
50～59	0.41～1.57	0.25～1.21	1.0～2.5	0.3～2.1
60以上			0.6～2.7	0.3～2.0

◆ 新旧相関図

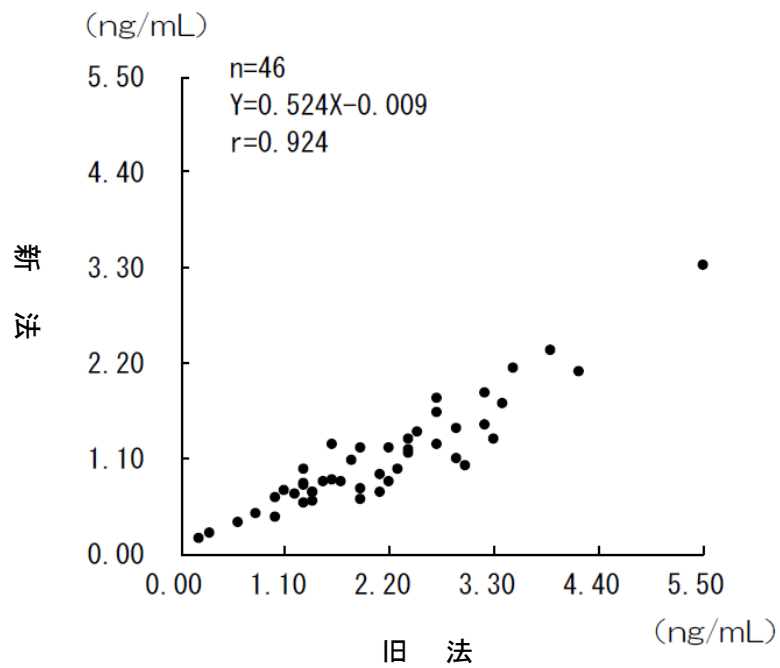

◆ 検査方法の参考文献

吉田 孝雄, 他: ホルモンと臨床 22 (5) : 671～676, 1974.